es

INSTRUCCIONES DEL USUARIO Y DE INSTALACIÓN

Del Arnés De Pierna

ART NOS. LH600S, LH600M & LH600L

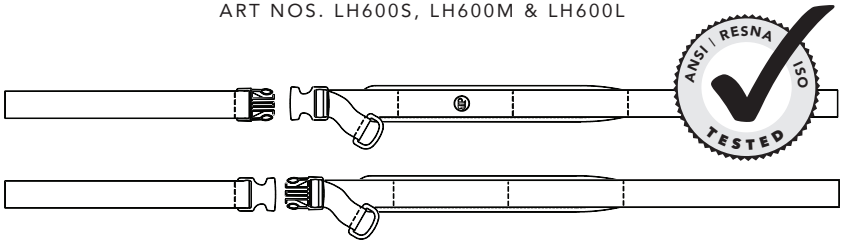

Estas instrucciones ofrecen información importante para el uso y el mantenimiento seguro de todos los arneses de pierna Bodypoint. Facilite estas instrucciones al usuario o a su cuidador y revíselas con ellos para asegurarse de que las comprendan.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** El producto debe ser instalado y colocado por un técnico de rehabilitación cualificado.

Para su instalación, este producto debe montarse con:

- Acoples terminales Flat-Mount
- Acoples terminales Cinch-Mount
- Hebilla de leva (2,5 cm [1 pulg.] adecuada para usuarios de hasta 75 kg, 3,8 cm [1-1/2 pulg.] y 5,08 cm [2 pulg.] adecuada para todos los usuarios)

El herraje de montaje opcional del cinturón Bodypoint puede utilizarse para sillas de ruedas y sistemas de asiento.

USO PREVISTO:

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Este producto solo debe usarse para colocar a una persona en la silla de ruedas o de trabajo. NO debe usarse como dispositivo de seguridad para transporte, ni como dispositivo de restricción personal o en cualquier otra aplicación en la que su mal funcionamiento podría causarle lesiones a la persona. El uso inapropiado de este producto no está autorizado y además es inseguro.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Este cinturón de posicionamiento pélvico debe usarse correctamente en las caderas en todo momento. Pídale a su especialista postural que le muestra la forma correcta de ajuste y uso.

- El desenganche accidental de este cinturón puede causar que el usuario se resbale o caiga de la silla de ruedas.
- La incapacidad de un usuario para soltarse por sí mismo puede ser peligrosa si se desliza hacia abajo o queda atrapado en la silla de ruedas durante una emergencia.

Si las habilidades físicas o cognitivas del usuario le impiden utilizar este cinturón de manera segura, un cuidador debe estar presente en todo momento durante su uso. Asegúrese de que todos los cuidadores sepan ajustar y desabrochar el producto de manera correcta.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** De igual forma que con cualquier nuevo soporte para asientos, este producto puede cambiar la forma de sentarse del paciente. Los pacientes deben continuar con sus actividades normales de alivio de presión y comprobación de integridad cutánea, no sólo en los lugares de contacto del producto, sino también en las zonas de presión principales como el sacro, las piernas y las nalgas. Si se produce un mayor enrojecimiento o irritación de la piel, no continúe usando el producto y consulte con su médico o especialista postural. De no hacerlo pueden producirse lesiones graves, como por ejemplo las úlceras de presión.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Si se produce un incidente grave relacionado con el uso de este producto, debe informarse al fabricante (Bodypoint, Inc.) y a la autoridad local competente.

COMPROBACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y DESEMPEÑO: para garantizar la seguridad del usuario, este producto debe revisarse periódicamente para determinar su correcto funcionamiento y los signos de desgaste. Si el producto no funciona correctamente o si se encuentra un desgaste significativo en las hebillas, los puntos de montaje, la cincha, las almohadillas o las costuras, deje de usarlo y contáctese con su proveedor para que sea reemplazado o reparado por personal cualificado de Bodypoint. Este producto no debe ser modificado ni reparado por personal no cualificado bajo ninguna circunstancia: la salud y la seguridad dependen de ello.

LIMPIEZA: En lavadora, agua caliente 60° C (140° F). No usar lejía. Secado en secadora a baja temperatura, o tendida. No planchar. (Si coloca el producto dentro de una bolsa de tela durante el lavado ayudará a evitar arañazos al producto y a la propia lavadora).

RESTOS/DESECHOS: el producto está fabricado con materiales que pueden desecharse de forma segura sin tomar precauciones especiales al final de su vida útil.

GARANTÍA: Este producto tiene una garantía limitada para toda la vida contra defectos de mano de obra y materiales derivados de un uso normal por el paciente original. Póngase en contacto con su suministrador o con Bodypoint si desea realizar reclamaciones bajo garantía.

Si desea obtener más información sobre productos de Bodypoint y una lista de distribuidores fuera de EE.UU., visite la página www.bodypoint.com

Bodypoint®

EC REP Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PD Terwolde
The Netherlands

CE MD Producto sanitario

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

© 2021 Bodypoint, Inc. All Rights Reserved.

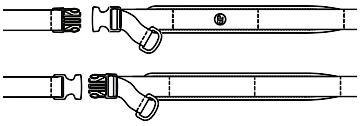

Ø 3/16–1/4" (5–6mm)



#2 Phillips

CONTENIDO DEL PAQUETE
- Arnés de pierna
- Accesorios Cinch-Mount™ o Flat-Mount™
- Abrazaderas FrameSaver™ (Opcional – N° Art.: FS032-2)

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN
- Destornillador Philips N° 2.
- Los tornillos de montaje deben tener una resistencia mínima a tirones de 90 kg/200 lbs. No incluidos en el paquete.



INSTALACIÓN
Siente al usuario en la silla de ruedas y establezca la postura correcta. Coloque la almohadilla del arnés de pierna contra el muslo interno con el extremo de la tira trasera pasando cerca de la pelvis y la articulación de la cadera. La almohadilla debería tocar el asiento, pero no debe extenderse bajo la pierna ni tocar el área de la ingle.



FrameSaver™



Cinch-Mount™



Flat-Mount™



TIRA FRONTAL
1. Pase la tira por debajo del muslo y coloque el punto de fijación deseado por delante de la barra del asiento o debajo el asiento.
2. Fije los accesorios a la estructura de la silla de ruedas.



TIRA TRASERA
1. Las tiras traseras deben fijarse a la parte trasera de la barra del asiento.
2. Coloque el punto de fijación deseado y fije los accesorios a la estructura de la silla de ruedas.



MONTAJE DIRECTO
Los accesorios pueden fijarse directamente a superficies de asiento sólidas. Los tornillos de montaje deben tener una resistencia mínima a tirones de 90 kg/200 lbs. (No incluidos en el paquete)



AJUSTE
Ajuste el arnés de pierna al usuario con una tira con anilla en forma de D. Desenrede cualquier parte suelta que quede en el accesorio trasero. Cuando esté correctamente ajustado y las tiras estén apretadas, debería encajar cómodamente, para que las piernas del usuario queden aseguradas.



COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD
Cuando el usuario esté sentado en la silla de ruedas correctamente, haga que se incline hacia delante y a los lados para comprobar cómo encaja.
Compruebe:
1. El funcionamiento normal de las hebillas y las correas de ajuste.
2. Comodidad: Busque zonas de irritación.
3. Interferencia con otros aparatos: Vuelva a colocar los puntos de fijación si es necesario.
4. Mueva la silla en todas las direcciones, incluyendo su inclinación, plegado y giro. Compruebe si hay alguna interferencia.